



دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز

آزمایشگاه الکترونیک عمومی

مدرس:

دکتر ذاکر حقیقی

مقدمات و آشنائی با تجهیزات

الف. ایمنی در آزمایشگاه

از آنجا که برای اکثر مردم و به خصوص آنها که به نحوی با برق سروکار دارند امکان برق گرفتگی وجود دارد، لازم است که هر کس اطلاعاتی درباره آن داشته باشد. در اینجا برخی از اعمالی را که دانستن و انجام آنها امکان یافتن زندگی دوباره را می دهد ذکر می کنیم. لازم است که در جلسه اول آزمایشگاه بخش مربوط به ایمنی و آشنائی با تجهیزات آزمایشگاه به دانشجویان تدریس شده و در جلسه بعد از آن امتحان گرفته شود.

جریان است که می کشد

ظاهراً چنین به نظر می رسد که شوک ناشی از ولتاژ ۱۰۰,۰۰۰ ولت کشنده تر از شوک ولتاژ ۱۰۰ ولتی است. اما چنین نیست. بسیاری از اشخاص در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی منزل که با برق شهر کار می کنند دچار برق گرفتگی شده اند و مرده اند، همچنین در صنعت برق گرفتگی منجر به فوت حتی برای افرادی که با برق ۴۲ ولت مستقیم کار می کرده اند، نیز پیش آمده است. اندازه حقیقی شدت شوک مربوط است به مقدار جریان (آمپر) که از بدن می گذرد. ولتاژ منبع وسیله الکتریکی که از برق منازل استفاده می کند در تحت شرایط معینی می تواند یک جریان کشنده ایجاد نماید. جریان های بیش از ۱۰ میلی آمپر (0.01 Amp) کمترین اثرشان درد بوده و ماکزیمم، شوک های جدی کشنده ایجاد می کنند. جریان های بیش از ۲۰۰ میلی آمپر (0.2 Amp) تولید سوختگی های خطرناک و بیهوشی می کنند و اگر برق زده فوراً تحت درمان قرار گیرد (به او تنفس مصنوعی داده شود) معمولاً کشنده نیستند. جریان های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی آمپر (0.1 تا 0.2) کشنده اند. عملاً بعد از اینکه شخصی دچار برق زدگی شد مشکل است تعیین شود که چه مقدار جریان از اعضای حیاتی بدنش عبور کرده است. به هر حال اگر تنفس بیمار قطع شده باشد باید فوراً به او تنفس مصنوعی داد.

اثرات فیزیولوژیکی شوک الکتریکی

شکل زیر اثرات فیزیولوژیکی ناشی از شدت جریان های مختلف را نشان می دهد. توجه کنید ولتاژ منظور نشده است اگرچه این ولتاژ است که جریان را برقرار می سازد ولی مقدار جریان شوک بر حسب مقاومت بدن (بر حسب نقاط اتصال) تغییر می کند. همان طور که در نمودار نشان داده شده خطر ناشی از شوک با افزایش جریان زیاد می شود. در جریان های حدود ۶۰ میلی آمپر تنفس سخت صورت می گیرد و بالاخره در جریان های حدود ۷۰ میلی آمپر تنفس قطع می شود وقتی جریان به ۱۰۰ میلی آمپر برسد حرکات نامنظم ماهیچه های بطن قلب سبب انقباض نامنظم و دیواره های بطن می شود. در بیش از ۲۰۰ میلی آمپر انقباض عضلانی به قدری شدید است که قلب در مدت شوک به شدت منقبض شده این انقباض مانع حرکت نامنظم ماهیچه های بطن می شود و در نتیجه برق زده شانس زنده ماندن بیشتری می یابد.

خطر ولتاژ کم

واضح است که تنفس مصنوعی در مورد مصدومین ولتاژهای زیاد نتایج سریع تری نسبت به مصدومین ولتاژهای کم می دهد دلیلش همان انقباض شدید قلب است که از جریان زیاد ناشی از ولتاژ زیاد حادث می شود. پس می توان نتیجه گرفت که ولتاژ ۷۰ ولتی به همان اندازه خطرناک است که ولتاژ ۷۰ میلی ولتی میتواند خطرناک باشد. مقاومت بدن بر حسب تغییر نقاط اتصال و شرایط پوست (خشک یا تر بودن آن) تغییر می کند مثلاً مقاومت واقع بین گوش ها بدون مقاومت پوست ۱۰۰ اهم است در حالی که بین دست و پا تا ۵۰۰ اهم است. مقاومت پوست از ۱۰۰۰ اهم برای پوست های مرطوب تا بیش از ۵۰۰,۰۰۰ اهم برای پوست های خشک تغییر می کند. وقتی در نزدیکی وسایل برقی به کار مشغولید به آهستگی حرکت کنید. حرکت پاهایتان طوری باشد که تعادل بدنتان را کاملاً حفظ نماید. اگر ابزاری به زمین افتاده برای برداشتن آن هجوم نبرید. قبل از دست زدن به سیم ها و نقاط اتصال دستگاه را خاموش کنید و نقاط با فشار زیاد را به زمین وصل کنید و توجه کنید که جریان تصادفاً و به طور ناگهانی برقرار نشود. وقتی از لحاظ روحی یا جسمی خسته اید وسایل برقی را مورد آزمایش قرار ندهید. وقتی وسایل برقی را آزمایش می کنید یک دستتان را در جیبتان قرار دهید. و مهم تر از همه وقتی بر روی کف فلزی یا ناحیه ای

مرطوب و یا سطوح متصل به زمین ایستاده اید به وسایل برقی دست نزنید. وقتی لباسهایتان مرطوب است (مخصوصاً کفش های مرطوب) و یا همچنین وقتی پوستتان مرطوب می باشد به وسایل الکتریکی دست نزنید. هیچ وقت به تنهایی کار نکنید. هر چه اطلاعاتتان راجع به دستگاه های الکتریکی بیشتر باشد عدم دقت و بی احتیاطی شما بیشتر می شود. هرگز به ریسک های غیرضروری مبادرت نکنید.

آنچه که درباره یک برق زده باید انجام داد

در وهله اول ولتاژ را قطع نموده و یا مصدوم را از محل اتصال جدا سازید ولی توجه کنید که در این حالت سلامت خود را به خطر نیندازید. برای جدا کردن مصدوم از محل اتصال باید از یک قطعه چوب خشک و یا طناب یا پتو و غیره استفاده کرد. وقت را جهت یافتن کلید قطع بیهوده تلف نکنید چون مقاومت بدن مصدوم با گذشت زمان رو به تحلیل می رود و اگر در عملیات تأخیر روا دارید جریان به حد جریان کشنده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی آمپر نزدیک می شود. اگر مصدوم به حالت بیهوشی افتاده و تنفس قطع شده، باید بلادرنگ تنفس مصنوعی را شروع کرد و تا وقتی که کاملاً به حالت طبیعی برگشته به آن ادامه دهید. شاید هشت ساعت طول بکشد تا مصدوم به زندگی باز

گردد. باید توجه داشت که گرفتگی کام و عدم وجود نبض از عوارض ناشی از برق گرفتگی بوده در صورت مشاهده آنها نباید تصور شود که مصدوم فوت شده است.



ب. دستورالعمل ایمنی

اگر شما در آزمایشگاه الکترونیک دانشکده مهندسی برق کار می‌کنید، شرایط کار ایمن را برای حفاظت از خود و اطرافیان‌تان فراهم کنید. دستورالعمل زیر را به دقت بخوانید و رعایت کنید. فراموش نکنیم که الویت اول ایمنی و سلامت و پس از آن انجام آزمایش است.


قبل از شروع کار، ابزار و دستگاه‌ها را چک کنید؛ هر نوع خرابی احتمالی را به استاد یا مسئول آزمایشگاه گزارش کنید.

۱. اگر با مدارها و ابزاری سروکار دارید که با ولتاژ بیش از $50V$ (پیک) کار می‌کنند، مطمئن شوید که شخص دیگری در محیط کار حضور دارد که می‌تواند شما را ببیند یا صدای شما را بشنود.
۲. اگر با مداری کار می‌کنید که با ولتاژ بیش از $50V$ تغذیه می‌شود باید مجوز لازم را از استاد خود کسب کرده و مسئول آزمایشگاه را در این زمینه مطلع سازید.
۳. منبع تغذیه آخرین بخش مدار است که متصل می‌شود و اولین بخشی است که از مدار قطع می‌گردد. اگر می‌خواهید بر روی مدار خود کار کنید ابتدا منبع تغذیه را خاموش کنید.
۴. سیمها را از روی اجسام متحرک یا در حال چرخش عبور ندهید؛ آنها را بر روی زمین و جایی که رفت‌وآمد است رها نکنید و از سیمهای دوتکه برای اتصال بخش‌های مختلف استفاده نکنید.
۵. اگر مدار سلفی را اتصال باز می‌کنید این کار را با دست چپ انجام دهید و صورت خود را از مدار دور کنید، احتمال بروز جرقه وجود دارد.
۶. اگر از خازنهای الکتrolیتی بزرگ استفاده می‌کنید، به بیشینه ولتاژ درج شده روی بدنه و پلاریته خازن دقت کنید در غیر این صورت احتمال ترکیدگی خازن وجود دارد. ممکن است این خازن‌ها برای تخلیه شدن به زمان نسبتاً زیادی (۵ برابر ثابت زمانی) نیاز داشته باشند.
۷. در هنگام کار با مدارهای الکتریکی از اشیای رسانا مانند ساعت‌های با بند فلزی، زنجیر و دستبند، قلم‌های بدنه فلزی، خط کشهای فلزی و ... استفاده نکنید.
۸. شما فقط مجاز به استفاده از ابزار و دستگاههای هستید که در محیط آزمایشگاه، وجود دارد، اگر نیاز به استفاده از ابزار دیگری دارید باید مجوز لازم را از مسئول آزمایشگاه کسب کنید.
۹. هرگز دستگاهها را جابجا و یا بر روی هم قرار ندهید.
۱۰. هرگز عجله نکنید، آگاهانه و با دقت کار کنید.
۱۱. پس از انجام کار و قبل از ترک آزمایشگاه، میز کار خود را مرتب کنید و تمام دستگاه‌ها و ابزار را خاموش نمایید.

دستگاههای موجود در آزمایشگاه

برای اینکه به درستی بتوان در آزمایشگاه با تجهیزات موجود کار کرد ابتدا باید نسبت به شناخت آن ها اقدام نمود. معمولا دانشجو در آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی با این تجهیزات و نحوه عملکرد آن ها آشنا می شود. اما به جهت یادآوری لازم دیدیم دوباره شرح مختصری از آن ها بیان کنیم. بنابراین در ابتدا به شرح دستگاههای موجود در آزمایشگاه و نحوه استفاده از آنها می پردازیم. لازم است دانشجو به مطالعه این موارد پرداخته و در جلسه دوم آزمایشگاه از این موارد از او امتحان به عمل آید.

ج. اسیلوسکوپ

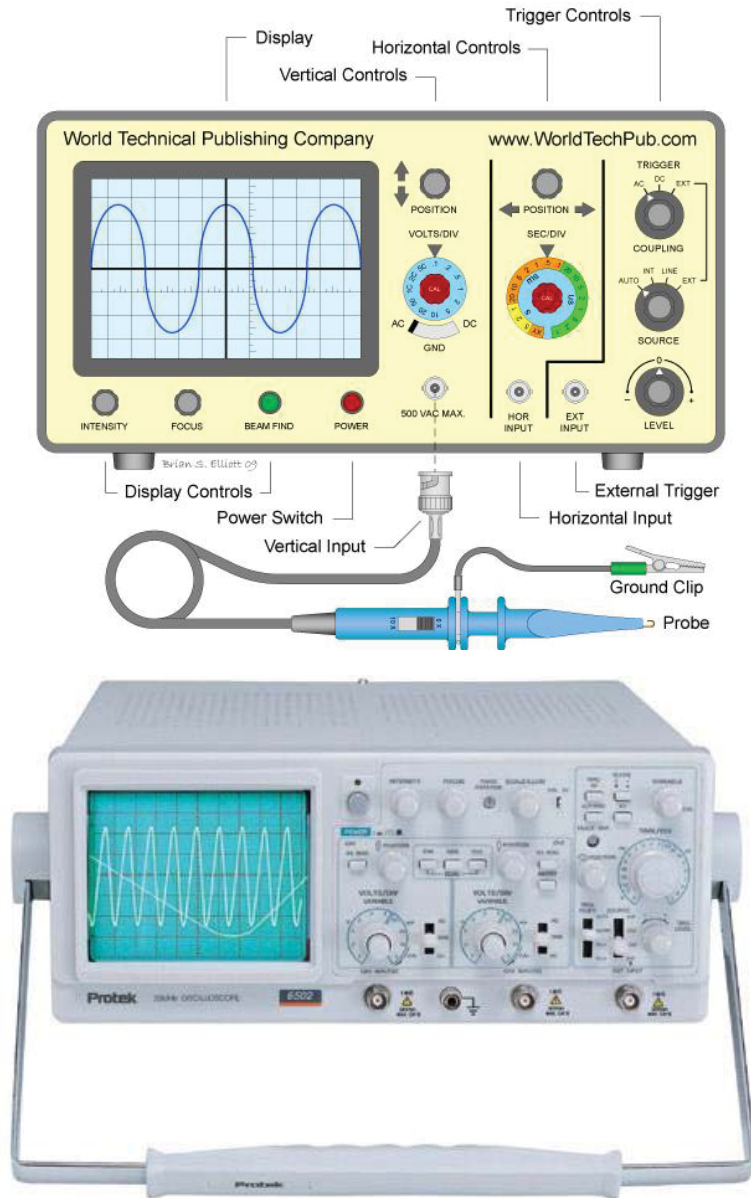

شکل (۱)

اسیلوسکوپ (Oscilloscope) یک دستگاه اندازه گیری است که از آن برای مشاهده شکل موج ها و اندازه گیری ولتاژ، زمان تناوب، اختلاف فاز و همچنین مشاهده منحنی مشخصه ولت - آمپر عناصر نیمه هادی مانند دیود و ترانزیستور استفاده می شود. اسیلوسکوپ یک ولت متر دقیق است ولی توانایی اندازه گیری جریان را به طور مستقیم ندارد و برای اندازه گیری جریان باید از روش های غیر مستقیم مانند قانون اهم استفاده کرد. یکی از مزایای اسیلوسکوپ این است که بر خلاف مولتی مترهای معمولی، در فرکانس های بالا نیز به خوبی کار می کند. اندازه گیری و مشاهده شکل موج ها در اسیلوسکوپ از ولتاژ با فرکانس صفر (DC) شروع و به فرکانس مشخصی ختم می گردد که معمولاً اسیلوسکوپ را با این فرکانس مشخص می کنند. مثلاً اسیلوسکوپ ۴۰ مگاهرتز، یعنی اسیلوسکوپی که می تواند ولتاژهای DC و AC تا ۴۰ MHz را نمایش دهد. اسیلوسکوپ ها در نوع آنالوگ و دیجیتال ساخته می شوند که ما در اینجا به بررسی نوع آنالوگ آن می پردازیم و در ادامه هر جا کلمه اسیلوسکوپ را به کار ببریم منظورمان اسیلوسکوپ آنالوگ است. فعلاً قصد نداریم به بررسی ساختمان داخلی اسیلوسکوپ بپردازیم بلکه هدف، آشنایی با قابلیت های اسیلوسکوپ و نحوه استفاده از آن می باشد. به دلیل اینکه طرز کار همه اسیلوسکوپ ها شبیه یکدیگر است و کلیدها و ولوم های آنها تقریباً یکی است برای آموزش بهتر مطلب، از یک اسیلوسکوپ Instek مدل GOS-630 در امر آموزش استفاده می کنیم که در آزمایشگاه موجود می باشد.



شکل (۲)

اسیلوسکوپ ها ممکن است یک کاناله و یا چند کاناله باشند. اسیلوسکوپ های یک کاناله در هر لحظه فقط می توانند یک سیگنال را روی صفحه نمایش خود نمایش دهند. اما اسیلوسکوپ های چند کاناله، همزمان می توانند چند سیگنال را روی صفحه نمایش خود، نمایش دهند. اسیلوسکوپ نمایش داده شده در شکل (۱)، یک اسیلوسکوپ دو کاناله می باشد یعنی همزمان قادر به نمایش دادن دو سیگنال روی صفحه نمایش خود می باشد. اما سیگنال های الکتریکی چگونه به اسیلوسکوپ منتقل می شوند؟ برای انتقال سیگنال های الکتریکی به اسیلوسکوپ، از پروب استفاده می شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

پروب: (Probe) برای انتقال سیگنال های الکتریکی به اسیلوسکوپ، از پروب استفاده می شود. یک نمونه پروب در شکل (۲) نمایش داده شده است. سیم رابط پروب معمولاً از جنس کابل کواکسیال می باشد تا میزان نویز به حداقل برسد. نوک پروب به صورت گیره ای فتری است که می توان آن را به یک نقطه از مدار وصل کرد. اگر پوشش پلاستیکی نوک پروب را برداریم، نوک آن به صورت سوزنی می شود که در بعضی مواقع از آن استفاده می گردد. انتهای فلزی سیم رابط که به ورودی اسیلوسکوپ وصل می شود BNC نام دارد و BNC دارای یک شیار مورب است که وقتی آن را به ورودی اسیلوسکوپ وصل می کنیم و ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم این قطعه کاملاً به اسیلوسکوپ متصل می شود. همچنین روی پروب کلیدی با دو حالت $\times 1$ و $\times 10$ وجود دارد که در حالت $\times 1$ ، سیگنال بدون هیچ گونه تضعیفی از طریق پروب به اسیلوسکوپ اعمال می گردد.



شکل (۳)

در حالت $\times 10$ ، ابتدا سیگنال در داخل پروب 10 برابر تضعیف شده و سپس به اسیلوسکوپ اعمال می گردد . باید توجه داشت که اگر از حالت $\times 10$ پروب ، برای اندازه گیری استفاده شود مقادیر قرائت شده دامنه را باید در عدد 10 ضرب نمود تا مقدار واقعی دامنه سیگنال بدست آید . موارد کاربرد $\times 10$ برای سیگنالهای با دامنه زیاد می باشد. در ادامه ابتدا به بررسی صفحه نمایش و کلیدها و ولوم های روی پانل اسیلوسکوپ می پردازیم و سپس به بررسی کاربردهای اسیلوسکوپ می پردازیم . برای نمایش بهتر پانل اسیلوسکوپ ، تصویری از نمای روبه روی اسیلوسکوپ در شکل (۳) نمایش داده شده است.

۱- صفحه نمایش اسیلوسکوپ : اسیلوسکوپ ها دارای یک صفحه نمایش هستند که این صفحه نمایش در راستای افقی به 10 قسمت و در راستای عمودی به 8 قسمت تقسیم می شود که برای دقت بیشتر در اندازه گیری ، در راستاهای افقی و عمودی ، خطوط وسط دارای تقسیمات ریزتری نیز می باشند به طوری که هر خانه به 5 قسمت تقسیم شده و هر قسمت معادل $0,2$ خانه است.

۲-۲ کلید روشن و خاموش کردن اسیلوسکوپ: در هر اسیلوسکوپ کلیدی برای روشن و خاموش کردن اسیلوسکوپ وجود دارد که آن را با کلمه POWER و یا ON/OFF نمایش می دهند . در نزدیکی این کلید ، معمولاً یک LED جهت نمایش روشن و یا خاموش بودن اسیلوسکوپ وجود دارد . در شکل (۲) این کلید در زیر و سمت راست صفحه نمایش قابل مشاهده است.

۳-۳ ولوم : Intensity این ولوم شدت نور سیگنال نمایش داده شده را کم و زیاد می کند . این ولوم باید در حالتی قرار گیرد که شدت نور برای رؤیت سیگنال کافی باشد . این ولوم ممکن است به اختصار با Inten نمایش داده شود . در شکل (2) در زیر صفحه نمایش دو ولوم وجود دارد . از این دو ولوم، ولوم سمت چپی، ولوم Inten می باشد.

۴- ولوم Focus : کلمه Focus به معنای کانونی و یا تمرکز است و این ولوم ضخامت موج رسم شده بر روی صفحه اسیلوسکوپ را کم و زیاد می کند . این ولوم باید در حالتی قرار داده شود که خطوط شکل موج ، حداقل ضخامت را داشته باشند . در شکل (۲) ، از بین دو ولوم زیر صفحه اسیلوسکوپ ، ولوم سمت راست ولوم Focus می باشد.

۵- پین تنظیمات یا کالیبراسیون : این قسمت برای تست و تنظیم سلکتورهای Volt/Div و Time/Div و نیز برای بررسی سالم و یا معیوب بودن پروب مورد استفاده قرار می گیرد . اسیلوسکوپ یک سیگنال مرجع با دامنه و

دستور کار آزمایشگاه الکترونیک

فرکانس معین برای تست و تنظیم خود ایجاد می کند و به این پین انتقال می دهد. اگر سیگنال مزبور به ورودی اسیلوسکوپ داده شود می توان شکل موج آن را مشاهده کرد. در عین حال چون دامنه و فرکانس سیگنال مزبور معین است، می توان صحت تنظیمات سلکتورهای Volt/Div و Time/Div را تحقیق کرد. همچنین اگر در اثر تماس نوک پروب با این پین، سیگنال موجود بر روی پین، در صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر شود و زمانی که گیره زمین پروب را همزمان با نوک پروب به این پین متصل می کنیم یک خط افقی و یا به عبارتی ولتاژ صفر، روی صفحه اسیلوسکوپ ظاهر شود پروب سالم است. در شکل (۲) این پین در زیر صفحه نمایش اسیلوسکوپ و در منتهی الیه سمت چپ قابل مشاهده است.

۶- پیچ آستیگمات: این پیچ به همراه ولوم تنظیم نقطه کانونی برای ایجاد واضح ترین نقطه گرد استفاده می شود و معمولاً با عبارت Astig مشخص می شود. بعضی از اسیلوسکوپ ها مثل اسیلوسکوپ نمایش داده شده در شکل (۳) این ولوم را ندارند.

۷- پیچ چرخش محور افقی: توسط این پیچ کجی محور افقی کاملاً در وضعیت افقی تصحیح می گردد. این ولوم با عبارت Trace Rotation مشخص می شود. در اسیلوسکوپ نمایش داده شده در شکل (۳)، این ولوم در سمت راست ولوم Focus قرار دارد.

برای بررسی بقیه ولوم ها و کلیدهای اسیلوسکوپ، تصویر واضح تری از نیمه سمت راست اسیلوسکوپ نمایش داده شده در شکل (۳)، در شکل (۴) نمایش داده شده است.



شکل (۴)

۸- کلید : Time/Div این کلید دارای ضرایبی بر حسب ثانیه ، میلی ثانیه و میکروثانیه است و این ضرایب نشان دهنده این هستند که چقدر زمان لازم است تا اشعه در راستای افقی به اندازه یک خانه جا به جا شود . مثلاً در شکل (۴) ضریب Time/Div برابر است با ۰,۲ میلی ثانیه و این یعنی اینکه در این حالت برای اینکه اشعه در راستای افقی به اندازه یک خانه جا به جا شود ۰,۲ میلی ثانیه یا ۲۰۰ میکروثانیه زمان لازم است .

۹- ولوم : Time Variable این ولوم برای فشردن و باز کردن شکل موج در راستای افقی استفاده می شود . برای اندازه گیری زمان تناوب توسط اسیلوسکوپ باید حتماً این ولوم تا آخر در جهت حرکت عقربه های ساعت چرخانده شده و روی علامت Cal قرار گیرد . اگر این ولوم از حالت Cal خارج شود ضرایب Time/Div دیگر معتبر نبوده و نمی توان زمان تناوب را محاسبه نمود . از این ولوم زمانی استفاده می شود که صحت ضرایب Time/Div اهمیتی نداشته باشد مثل زمانی که می خواهیم اختلاف فاز دو موج هم فرکانس را محاسبه کنیم .

۱۰- کلید بزرگنمایی در راستای افقی : توسط این کلید می توان مقیاس افقی را به میزان ۵ و یا ۱۰ برابر بزرگ نمود . به این ترتیب که در حالت عادی مقیاس افقی همان است که سلکتور Time/Div نشان می دهد اما در حالت انتخاب این کلید ، شکل موج در جهت افقی ۵ و یا ۱۰ برابر باز می شود و این معادل این است که عدد نشان داده شده توسط سلکتور Time/Div به ۵ و یا ۱۰ تقسیم شده باشد . در بعضی از اسیلوسکوپ ها کلید بزرگنمایی افقی جزئی از همان ولوم تغییر مکان افقی (Horizontal Position) می باشد . به این صورت که وقتی این ولوم داخل است ، بزرگنمایی غیر فعال بوده و وقتی این ولوم بیرون کشیده می شود ، بزرگنمایی فعال می شود . مورد استفاده کلید بزرگنمایی افقی در مورد نمایش امواج با فرکانس زیاد است . این کلید با MAG به همراه ۵× و یا ۱۰× نمایش داده می شود .

۱۱- کلید بزرگنمایی در راستای افقی : این کلید نیز همانند کلید بزرگنمایی در راستای عمودی است و در مواقعی که دامنه ولتاژ خیلی کم است مورد استفاده قرار می گیرد . در این صورت میزان ولتاژ اندازه گیری شده توسط اسیلوسکوپ باید بر ضریب کلید بزرگنمایی تقسیم شود .

۱۲- ولوم تغییر مکان افقی : (Horizontal Position) این ولوم شکل موج را در جهت افقی جا به جا می کند . این ولوم ممکن است به اختصار با Hor.Pos و یا با علامت ◀ ▶ نشان داده می شود .

۱۳- کلید : Volt/Div این کلید نیز همانند کلید Time/Div دارای ضرایبی است که این ضرایب بر حسب ولت و میلی ولت می باشند و هر ضریب بیان کننده این است که هر خانه در راستای عمودی چند ولت می باشد . این کلید برای اندازه گیری دامنه ولتاژ به کار می رود . با تغییر این کلید ، شکل موج در راستای عمودی باز و جمع می شود . مثلاً در شکل (۴) ، ضریب کلید Volt/Div کانال ۲ برابر با ۰,۵ ولت می باشد که این امر نشان دهنده این است که به ازای انتخاب کانال ۲ ، در صفحه نمایش اسیلوسکوپ هر خانه در راستای عمودی برابر با ۰,۵ ولت می باشد .

۱۴- ولوم : Volt Variable این ولوم شکل موج را در راستای عمودی فشرده و باز می کند . اما اگر این ولوم از حالت Cal خارج شود دیگر مقادیر Volt/Div معتبر نبوده و نمی توان اندازه ولتاژ را محاسبه نمود . بنابراین این ولوم هنگام اندازه گیری ولتاژ باید روی علامت Cal باشد .

۱۵- ولوم : Vertical Position این ولوم شکل موج را در راستای عمودی جا به جا می کند و ممکن است به اختصار با Ver.Pos و یا با استفاده از علامت های ▼ و ▲ نمایش داده شود .

۱۶- پیچ بالانس : DC به دلیل استفاده از اسیلوسکوپ در مناطق و حرارت های متفاوت می بایست سلکتورهای Volt/Div هر یک از دو کانال ، از نظر DC بالانس شوند . با تنظیم این پیچ ها باید حالتی را انتخاب نمود که در آن حالت با تغییر سلکتور Volt/Div ، خط افقی هیچ تغییر مکانی در جهت عمودی نداشته باشد . این پیچ ها معمولاً با DC-Bal مشخص می شوند .

۱۷- کلید : AC-GND-DC اگر این کلید در حالت AC باشد یک خازن در مسیر ورودی اسیلوسکوپ قرار می گیرد که سبب حذف مؤلفه DC شکل موج می گردد . یعنی در این حالت فقط سیگنال های AC روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، نمایش داده می شوند و سیگنال های DC حذف می شوند . اما اگر این کلید در حالت DC باشد هر چه در ورودی باشد بدون تغییر در صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، نمایش داده می شود . یعنی در این حالت مؤلفه های AC و DC روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، نمایش داده می شوند و در صورتی که این کلید در حالت GND باشد ورودی اسیلوسکوپ به صفحات انحراف عمودی که در ادامه در رابطه با آنها صحبت می کنیم منتقل نخواهد شد بلکه این صفحات به اختلاف پتانسیل صفر ولت متصل می شوند . بنابراین در این حالت روی صفحه اسیلوسکوپ یک خط افقی دیده می شود که از آن برای تعیین خط مبنای عمودی و یا ولتاژ صفر ولت استفاده می شود .

۱۸- کلید : ADD-DUAL-CH2-CH1 اگر این کلید در حالت CH1 باشد فقط سیگنال اعمال شده به کانال ۱ روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود و اگر این کلید در حالت CH2 باشد فقط سیگنال اعمال شده به کانال ۲ روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود . در صورتی که DUAL را انتخاب کنیم شکل موج های هر دو کانال همزمان روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شوند و در صورت انتخاب ADD حاصل جمع لحظه ای دو شکل موج روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود .

۱۹- کلید : CHOP-ALT اگر فرکانس سیگنال های ورودی بیشتر از ۱ KHZ باشد با استفاده از حالت ALT می توانیم دو شکل موج را به طور همزمان در صفحه نمایش اسیلوسکوپ مشاهده کنیم . در این حالت در یک دوره تناوب موج (Ramp در ادامه در رابطه با موج Ramp صحبت خواهیم کرد) ، سیگنال اعمال شده به کانال ۱ و در دوره تناوب بعدی این موج ، سیگنال اعمال شده به کانال ۲ روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، نمایش داده می شود اما به دلیل فرکانس بالای موج Ramp و سیگنال های ورودی ، سیگنال های هر دو کانال به طور همزمان بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ قابل مشاهده هستند . اما اگر فرکانس سیگنال های ورودی کم باشد مشاهده دو شکل موج به طور همزمان در حالت انتخاب ALT امکان پذیر نخواهد بود . زیرا در این صورت وقتی اسیلوسکوپ سیگنال کانال ۱ را نمایش می دهد سیگنال کانال ۲ از دید محو می شود و وقتی اسیلوسکوپ سیگنال کانال ۲ را نمایش می دهد سیگنال کانال ۱ از دید محو می شود و بنابراین دو موج به صورت چشمک زن روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می شوند . برای نمایش سیگنال های با فرکانس کم از حالت CHOP استفاده می کنیم . در این حالت یک نقطه کوچک از سیگنال کانال ۱ و سپس یک نقطه کوچک از سیگنال کانال ۲ و به همین ترتیب تا آخر نمایش داده می شود . در این روش لحظه ای که سیگنال کانال ۱ نمایش داده می شود کانال ۲ قطع است و برعکس در لحظه ای که سیگنال کانال ۲ نمایش داده می شود کانال ۱ قطع است اما چون این نقاط فوق العاده کوچک هستند ما آنها را کنار هم و به صورت پیوسته مشاهده می کنیم و در نتیجه دو شکل موج به طور همزمان بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ قابل مشاهده هستند

۲۰- کلید : CH2INV زمانی که این کلید انتخاب می شود شکل موج کانال ۲ به اندازه ۱۸۰ درجه اختلاف فاز پیدا می کند.

۲۱- کلید: X-Y اگر این کلید فعال شود ارتباط موج Ramp با صفحات افقی قطع شده و هر یک از سیگنال های ورودی به یکی از صفحات انحراف افقی یا عمودی اعمال می شود . مثلاً در اسیلوسکوپ نمایش، داده شده در شکل (۴) همانطور که مشاهده می کنید در کنار ترمینال ورودی کانال ۱ حرف X و در کنار ترمینال ورودی کانال ۲ حرف Y درج شده است . بنابراین در این اسیلوسکوپ ، در حالت انتخاب کلید X-Y ، سیگنال ورودی کانال ۱ به صفحات انحراف افقی و سیگنال ورودی کانال ۲ به صفحات انحراف عمودی اعمال می شود . این کلید برای مشاهده منحنی مشخصه ولت - آمپر عناصر نیمه هادی و نیز مشاهده اشکال لیسازور کاربرد دارد. در هر اسیلوسکوپی قسمتی مربوط به کنترل تریگر وجود دارد که در ادامه می خواهیم به بررسی آن بپردازیم اما قبل از معرفی کلیدها و ولوم های این قسمت به سؤالی که ممکن است برای بعضی ها مطرح شود پاسخ می دهیم و آن سؤال این است که منظور از تریگر چیست ؟ برای پاسخ به این سؤال باید مطالبی را در مورد ساختمان داخلی اسیلوسکوپ بدانید . در اسیلوسکوپ در ابتدا یک اشعه الکترونی تولید می شود . منظور از اشعه الکترونی تعداد زیادی الکترون می باشد که به صورت یک اشعه فوق العاده باریک درآمده و با سرعت بسیار زیاد (چند هزار کیلومتر در ثانیه) در حرکت است . زمانی که این اشعه الکترونی با سرعت زیاد با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمایش اسیلوسکوپ برخورد می کند مواد فسفرسانس از خود نور تولید می کنند . برای اینکه این اشعه الکترونی شکل موج ها را روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش دهد لازم است در دو جهت عمودی و افقی حرکت کند و بر این اساس دو سری صفحه به نام های صفحات انحراف عمودی و صفحات انحراف افقی را در مسیر حرکت اشعه الکترونی قرار می دهند . هر سری از این صفحات ، خود شامل دو صفحه موازی می باشد .

در اثر ایجاد اختلاف پتانسیل بین دو صفحه موازی ، اشعه الکترونی به سمت صفحه دارای پتانسیل بیشتر متمایل می شود و به این ترتیب محل برخورد اشعه الکترونی با مواد فسفرسانس پشت صفحه نمایش تغییر می کند و در نتیجه محل تولید نور روی صفحه نمایش تغییر می کند . سیگنالی که ما می خواهیم روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود به صفحات انحراف عمودی اعمال می شود و متناسب با تغییرات دامنه این سیگنال ، اشعه الکترونی در راستای عمودی جا به جا می شود . اما برای اینکه شکل موج به طور صحیح روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود باید همزمان با جا به جا شدن اشعه در راستای عمودی ، اشعه در راستای افقی نیز جا به جا شود . مثلاً اگر هدف ، نمایش یک موج سینوسی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ باشد با رسیدن موج سینوسی به صفحات انحراف عمودی ، اشعه الکترونی متناسب با دامنه موج سینوسی در راستای عمودی جا به جا می شود و اگر هیچ موجی به صفحات انحراف افقی اعمال نشود ، روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ به جای یک موج سینوسی فقط یک خط عمودی دیده می شود . بنابراین همیشه باید همزمان با سیگنال ورودی ، یک موج به صفحات انحراف افقی اعمال شود تا شکل موج ورودی به درستی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده شود . این موج را موج Ramp می گویند که یک موج دندانه اریه ای است . اگر فرکانس موج Ramp با فرکانس سیگنال ورودی یکی باشد یک سیکل کامل از موج ورودی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود و اگر فرکانس موج Ramp بیش از فرکانس سیگنال ورودی باشد چند سیکل از سیگنال ورودی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ نمایش داده می شود . برای اینکه شکل موج ساکنی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ داشته باشیم لازم است تا حرکت افقی اشعه الکترونی هر بار از محل مشخصی از سیگنال ورودی شروع شود که این وظیفه

بر عهده قسمت تریگر اسیلوسکوپ می باشد . اگر عمل تریگر انجام نشود ممکن است سیگنال ورودی در صفحه نمایش اسیلوسکوپ حرکت کند . برای عمل تریگر روش های مختلفی وجود دارد و بر این اساس کلیدهایی بر روی پانل اسیلوسکوپ تعبیه شده است که به وسیله آنها می توان نوع تریگر را انتخاب نمود . این کلیدها عبارتند از:

۲۲- کلید: Auto-Normal اگر این کلید در حالت Auto باشد حتی اگر به ورودی اسیلوسکوپ سیگنالی اعمال نشود مدار داخلی اسیلوسکوپ یک موج دنداناره اریه ای به صفحات انحراف افقی اعمال می کند و بنابراین خطی افقی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می شود که نشان دهنده آماده به کار بودن اسیلوسکوپ است . اما در صورتی که این کلید در حالت Normal باشد عمل تریگر فقط به کمک موج ورودی انجام می شود و لذا در صورتی که ورودی نداشته باشیم هیچ گونه خطی و یا موجی بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر نخواهد شد . این کلید در حالت عادی باید بر روی Auto باشد

۲۳- کلید Source Trigger: این کلید ممکن است دارای حالت های زیر باشد.

الف: AC (در این حالت عمل تریگر با مؤلفه AC انجام می شود).

ب: DC (در این حالت عمل تریگر با خود موج به اضافه مؤلفه DC انجام می شود).
پ: CH1 (در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال اعمال شده به کانال ۱ انجام می شود).
ت: CH2 (در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال اعمال شده به کانال ۲ انجام می شود).
ث: Line (در این حالت عمل تریگر با فرکانس برق شهر انجام می شود).
ج: Ext (در این حالت باید موجی را که می خواهیم توسط آن عمل تریگر انجام شود از خارج اسیلوسکوپ و توسط ترمینال مخصوص آن به اسیلوسکوپ اعمال کنیم)

چ: TV (در این حالت یک فیلتر پایین گذر مؤلفه های فرکانس بالای موج ورودی را حذف نموده و سپس عمل تریگر انجام می شود . این کلید در حالتی استفاده می شود که یک موج مزاحم بر روی موج اصلی ، مانع عمل تریگر شود).

ح: TV-H (در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال های افقی تلویزیون انجام می شود).
خ: TV-L (در این حالت عمل تریگر توسط سیگنال های عمودی تلویزیون انجام می شود)
۲۴- ولوم: Level این ولوم نقطه شروع موج نشان داده شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را معین می کند . همچنین اگر موج نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ، در جهت افقی حرکت کند و ثابت نباشد باید به کمک این ولوم شکل موج را ثابت نگهداشت .

۲۵- کلید: Slope این کلید مشخص کننده این است که اولین نیم سیکل موج نشان داده شده مثبت و یا منفی می باشد . در حالت عادی باید علامت مثبت (+) انتخاب شود . در واقع علامت مثبت (+) به معنای شیب مثبت و علامت منفی (-) به معنای شیب منفی در نقطه شروع موج می باشد .
حال که با کلیدها و ولوم های پانل اسیلوسکوپ آشنا شدید در ادامه به بررسی نحوه اندازه گیری ولتاژ، زمان تناوب ، فرکانس ، اختلاف فاز توسط اسیلوسکوپ می پردازیم .

د. اندازه گیری های فرکانسی و فازی:

تئوری: برای اندازه گیری فرکانس یک موج می توان آن را به ورودی Y اسیلوسکپ وصل کرد و فرکانس مربوطه را مستقیماً از روی درجه بندی صفحه اسیلوسکپ اندازه گرفت. در این حالت موج جاروب کننده محور X ها، مستقیماً توسط مولد داخلی اسیلوسکپ تأمین می گردد. (کلید X-DEFL در وضعیت INT است) برای اندازه گیری فرکانس همچنین می توان از منحنی های لیسازو کمک گرفت. در این صورت بایستی ارتباط داخلی اسیلوسکپ را از مولد موج جاروب کننده آن قطع کرد (کلید X-DEFL در وضعیت Ext باشد) سپس موج با فرکانس مجهول را به ورودی Y و یک موج با فرکانس معلوم را از خارج به ورودی X اسیلوسکپ مربوط ساخت. در این حالت هنگامی یک شکل ثابت روی صفحه اسیلوسکپ دیده می شود که فرکانس یکی از آنها مضرب صحیحی از فرکانس دیگر باشد. شکل زیر ترکیب دو موج با فرکانس هایی به نسبت ۱ و ۲ را نشان می دهد. (فرکانس Y دو برابر فرکانس X است)

اندازه گیری فاز:

اگر دو موج سینوسی که فرکانس های آنان مساوی ولی فاز آنها متفاوت باشد به اسیلوسکپ داده شود. اختلاف فاز آنها را می توان به ترتیب زیر پیدا کرد. اگر موج Y نسبت به موج X به اندازه زاویه α تقدم فاز داشته باشد و اگر دامنه دو موج مزبور در روی صفحه اسیلوسکپ مساوی دیده شوند خواهیم داشت:

$$x = A \sin 2\pi ft, y = A \sin(2\pi ft + \alpha)$$

$$y = A \sin(2\pi ft) \cos \alpha + A \cos(2\pi ft) \sin \alpha$$

با به کار بردن شرایط مرزی در $t=0$ ، $\cos 2\pi ft = 1, \sin 2\pi ft = 0$


$$y = +A \sin \alpha \Rightarrow \sin \alpha = \frac{y}{A}$$

$$t = 0, y = B \Rightarrow \sin \alpha = \frac{B}{A}$$

در این صورت مطابق شکل یک بیضی که در یک مربع محاط است به روی صفحه اسیلوسکپ ظاهر می شود. با توجه به شکل داریم:

$$\sin \alpha = \frac{B}{A}$$

که A و B را به وسیله قرار دادن یک صفحه اسیلوسکپ می توان تعیین کرد. برای دقت عمل بیشتر ممکن است طول های $2A$ و $2B$ را اندازه گرفت.

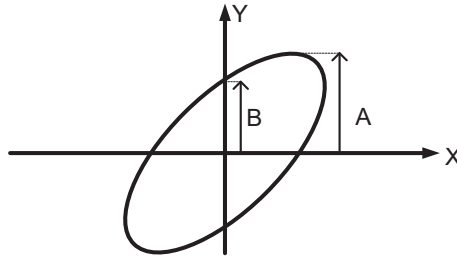

شکل ۵.

اندازه گیری ولتاژ:

اسیلوسکوپ را می توان به عنوان ولتمتر با مقاومت داخلی زیاد در مواردی که ولتمتر معمولی سبب تغییر مشخصات مدار می گردد به کار برد. ولتاژی که باید اندازه گرفته شود به ورودی Δ اسیلوسکوپ وصل نبوده و بازده (*gain*) تقویت کننده را طوری تنظیم می نمائیم که موج با دامنه مناسبی روی صفحه ظاهر گردد. سپس بدون تغییر دادن *gain* تقویت کننده، ولتاژ قابل تنظیم دیگری را به ورودی Δ اسیلوسکوپ وصل کرده و دامنه آن را طوری تنظیم می نمائیم که منطبق با دامنه ولتاژ مورد نیاز باشد. اندازه گیری این ولتاژ به وسیله یک ولتمتر منجر به تعیین اندازه ولتاژی که به اسیلوسکوپ داده ایم می گردد. به طور کلی می توان با استفاده از یک منبع ولتاژ مشخصی صفحه اسیلوسکوپ را مدرج کرد به طوری که تعیین شود که هر سانتی متر از محور قائم صفحه معادل با چند ولت است و در نتیجه دامنه هر ولتاژ غیر مشخص تعیین می گردد.

طرز کار با اسیلوسکوپ:

قبل از وصل اسیلوسکوپ به برق شهر نکات زیر را رعایت کنید.

الف: کلیدهای *Intensity* روی صفر بوده و *Power-on* در وضعیت OFF باشد.

ب: کلید *Focus* روی مقدار متوسط باشد.

ج: اسیلوسکوپ را به برق شهر (220 ولت) وصل کرده و کلید *Power-on* را در وضعیت روشن قرار دهید. مواظب باشید شدت نور (*Intensity*) را زیاد نکنید.

د: تأمل کنید تا دستگاه حدود ۳۰ ثانیه گرم شود و سپس شدت نور را آهسته زیاد کنید تا خط روشن روی پرده مشاهده گردد.

ه: با کلیدهای تنظیم افقی و قائم خط را در مرکز صفحه قرار دهید.

توجه: پس از مشاهده خط روشن هیچ وقت شدت نور را زیادتر نکنید. شدت نور زیاد سبب خرابی صفحه و تقلیل عمر مفید می گردد. ضمناً نباید هیچ گاه برای مدت طولانی یک نقطه روشن و یا یک موج که شدت نور آن زیاد و نیز متمرکز است روی صفحه باقی بماند.

سیگنال ژنراتور

سیگنال ژنراتور یا فانکشن ژنراتور دستگاهی است برای تولید انواع امواج الکتریکی از قبیل سینوسی - مربعی - مثلثی و دندانه اره ای که فرکانس و دامنه آنها قابل تنظیم می باشد. سیگنال ژنراتورهای موجود در آزمایشگاه از نوع لیدر و اسکورت میباشد. که عکس نوع اسکورت در بالا آمده است. این دستگاه دارای تنظیمات زیر می باشد.

ولوم تنظیم فرکانس : با این ولوم می توان فرکانس موج خروجی را ۱ هرتز تا ۱۰ مگا هرتز تنظیم نمود

ولوم تنظیم دامنه: این ولوم برای تنظیم دامنه موج خروجی از میلی ولت تا ۱۸ ولت بکار می رود برای تنظیم دامنه میلی ولت باید از تضعیف ۲۰ دی بی - ۴۰ دی بی یا ۶۰ دی بی استفاده نمود.

این فانکشن ژنراتور ها دارای قابلیت تنظیم عرض پالس می باشند.

در هنگام استفاده از دستگاه باید دقت نمود که دو سر پروب خروجی اتصال کوتاه نشود.

منبع تغذیه

منبع تغذیه ولتاژ DC از صفر تا ۳۰ ولت با قابلیت جریان دهی تا ۳ آمپر را تولید می کند. منبع تغذیه های موجود در آزمایشگاه از نوع صا ایران مدل ۸۳۰۳ می باشد که خروجی آن دارای مدار حفاظت در برابر اتصال کوتاه می باشد. در هنگام استفاده از منبع تغذیه باید دقت نمود که ولوم جریان بر روی مینیمم باشد تا در صورت معیوب بودن مدار جریان زیادی از منبع کشیده نشود.